

4ch温度ロガー SK-L400T

取扱説明書 (仕様編)

SK SATO

はじめに

このたびは4ch温度ロガー「SK-L400T」をお買い上げいただきありがとうございます。ごさいました。

- ◎この製品は、K熱電対センサを接続して温度をはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。
 - ◎ご使用前には必ず取扱説明書(本書)および別紙「取扱説明書(操作編)」をお読みになり、大切に保管してください。
- ご使用前に付属品が不足していないか、本器が輸送中に破損していないかご確認ください。万一付属品が不足していたり、本器や付属品が破損している場合は、お買い上げ店または弊社にご連絡ください。



警告

本器は防爆仕様構造ではありませんので、引火性ガスを含んだ雰囲気では絶対に使用しないでください。



爆発注意

爆発するおそれがあり大変危険です。

ご不明な点がありましたらお買い上げ店または弊社にご相談ください。



注意

- 本器を正しくご使用いただくために、以下のことをお守りください。
- ・本器は精密にできていますので落下させたり、振動や衝撃を与えないでください。
 - ・使用環境条件範囲外でのご使用は故障や破損の原因となりますので、使用環境条件範囲内でご使用ください。
 - ・直射日光のあたる場所や熱器具の近くでのご使用はやめてください。ケースの変形や故障の原因となります。
 - ・本器は防水構造ではありませんので、絶対に濡らさないでください。
 - ・屋外で使用するときは雨水にからないようにしてください。濡れた場合は故障の原因となります。
 - ・自動車内などに放置すると、真夏の炎天下では極度の高温になり、本器が故障するおそれがあります。このような場所には放置しないでください。
 - ・電氣的ノイズが発生する環境(IH調理器付近など)でご使用になりますと、表示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があります。
 - ・分解、改造しますと故障の原因となりますので、絶対にしないでください。
 - ・本器のお手入れにはアルコール、シンナー、その他溶剤などを使用しないでください。本器が変形、変質したり故障したりするおそれがあります。汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませたタオルなどをよくしぼってから拭いてください。
 - ・長期間使用しない場合は電池を取り外してください。電池を入れたままにしておきますと電池から液漏れする場合があります、故障の原因となります。また、電池を直接ハンダ付け、ショート、分解、加熱などしないでください。発熱、液漏れ、破裂する場合があります。電池が液漏れして液体が衣服に付着した場合は、液体に素手で触らずにすぐに水で洗い流してください。液体が皮膚に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときは水で洗った後、すぐに医師に相談してください。
 - ・不要になった電池は火中に投入しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂などによりけがや、やけどをするおそれがあります。
 - ・電池は乳幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。
- 修理および校正はお買い上げ店または弊社へお申し付けください。

Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

概要

本器はK熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。

特長

- 4箇所の温度を同時測定
最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。
見やすい大きな液晶表示で4箇所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。
K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。
- SDカードに測定値を記録
測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。
解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。
- 手動記録や予約記録、メモ機能
手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。
- 温度上下限警報機能
4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。
- 多彩な演算表示機能
最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載。
- バックライト機能
暗所での読み取りに便利です。
- 三脚に取り付け可能
本体背面に三脚取り付け用のネジ穴を装備。設置に便利です。

保証規定

- 1) 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ後1年間、無償で修理または交換させていただきます。その他の責はご容赦願います。
- 2) 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買い上げ店または弊社にご持参またはご送付ください。
- 3) 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
イ. 誤用・乱用および取扱不注意による故障
ロ. 火災・地震・水害等の災害による故障
ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
ニ. 使用中に生じた傷等の外観上の変化
ホ. 消耗品および付属品の交換
ヘ. 本証の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名等)の記入がない場合
- 4) 本証は日本国内でのみ有効です。また本証は再発行いたしません。大切に保管してください。

品質保証書

お願い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印箇所にご記入の上、本器の最終ご使用者のお手元に保管してください。

※当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、製品の修理・交換の製品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

製品名 4ch温度ロガー 型式 SK-L400T

※お客様名

※ご住所

※TEL

●以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印をお願いいたします。

お買い上げ店名

ご住所

TEL

お買い上げ年月日 年 月 日




株式会社佐藤計量器製作所

101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-4

SK SATO TEL 03-3254-8111 FAX 03-3254-8119


各部の名称

●本体部

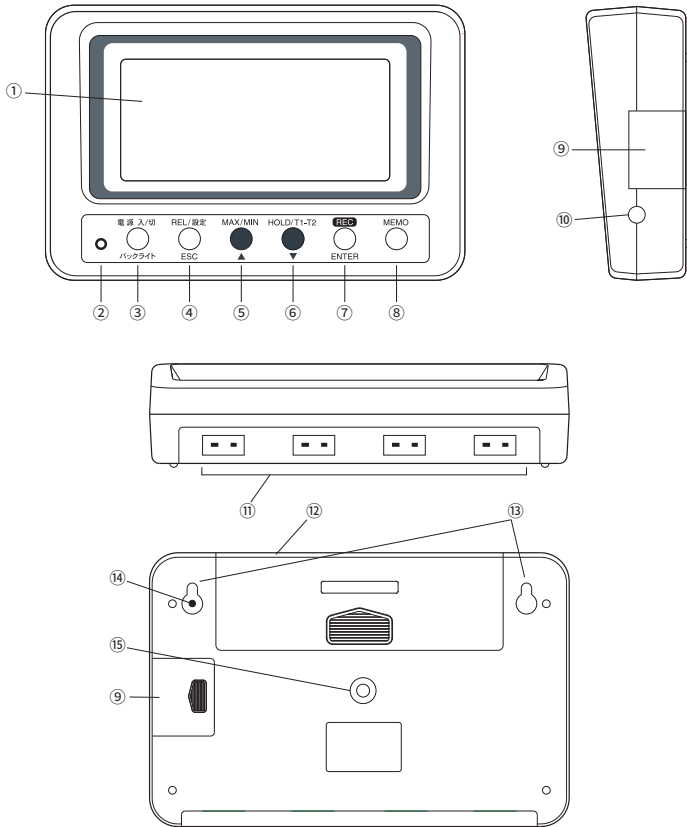

- ①表示部 : 測定値や本器の状態を示します。
 ②LEDランプ : 警報動作時に点滅します。
 ③電源/バックライトキー : 電源ON/OFFキーです。またバックライト点灯時に使用します。
 ④REL/設定/ESCキー : REL機能キーです。また測定状態と設定モードの切り替えに使用します。
 ⑤MAX/MIN/▲キー : MAX/MIN切り替えキーです。設定モードでは項目や値を進めます。また記録中の表示のON/OFFを切り替えます。
 ⑥HOLD/T1-T2/▼キー : 測定値を固定(HOLD)するキーです。またT1-T2機能の切り替えに使用します。設定モードでは項目や値を戻します。
 ⑦REC/ENTERキー : 記録を開始するキーです。設定モードでは値の確定に使用します。
 ⑧MEMOキー : メモ機能キーです。
 ⑨SDカードフタ : SDカードをセットする部分です。
 ⑩ACアダプタ端子 : ACアダプタを接続する端子です。
 ⑪熱電対端子 : 熱電対センサを接続する端子です。左からチャンネル1、2、3、4の順番です。
 ⑫電池フタ : 電池をセットする部分です。
 ⑬壁掛フック穴 : 壁に掛けるときに使用します。
 ⑭リセットボタン : 異常表示になった場合、初期化するボタンです。
 ⑮三脚取り付け穴 : 三脚取り付け用のネジ穴です。

●表示部

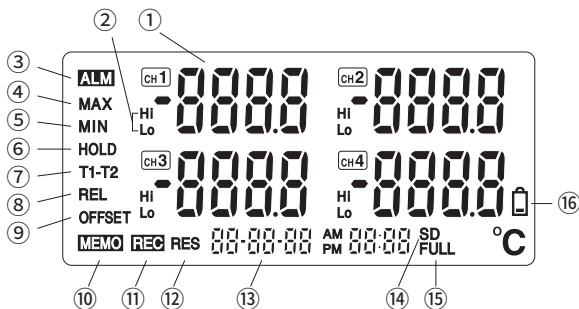

- ①温度表示部 : 温度測定値を表示します。
 ②Hi/Lo : 設定モードでは各種設定内容を表示します。
 ③ALM : 警報設定値を超えたときに点滅します。
 ④MAX : 最高値(MAX)表示中に点灯します。
 ⑤MIN : 最低値(MIN)表示中に点灯します。
 ⑥HOLD : 表示を固定(HOLD)しているときに点灯します。
 ⑦T1-T2 : T1-T2表示中に点灯します。
 ⑧REL : REL表示中に点灯します。
 ⑨OFFSET : オフセット値が設定されているときに点灯します。
 ⑩MEMO : メモ動作中に点灯します。
 ⑪REC : 記録中に点灯します。
 ⑫RES : 予約待機中に点灯します。
 ⑬時計表示部 : 年月日、時刻を表示します。
 ⑭SD : SDカード挿入中に点灯します。
 ⑮FULL : SDカードの空き容量が無い場合に点灯します。
 ⑯ローバッテリーマーク : 電池残量が少ない場合に点灯します。

仕様

製品名	4ch温度ロガー
型式	SK-L400T
製品番号	8191-00
接続センサ	K熱電対センサ ※コネクタ: K熱電対用 ASTM (旧ANSI) ミニチュアコネクタ
センサ接続数	4チャンネル
表示範囲	-202.0~1372°C
本体精度	±(0.3% rdg + 1) °C at 23°C ± 5°C ※測定精度は接続するセンサによって異なります。 ※表面温度センサ接続の場合、上記精度+2%rdgとなります。
温度係数	±(0.01% rdg + 0.1) °C/°C (18~28°C以外)
許容信号源抵抗	200Ω以下
分解能	0.1°C (-202.0~999.9°C) 1°C (上記以外)
測定サンプリング	約1秒(4チャンネル)
記録間隔	1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒 1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
使用環境条件	0~50°C、85% rh以下(結露なきこと)
保管環境条件	0~50°C、85% rh以下(結露なきこと)
電源	単3形アルカリ電池4本、または単3形ニッケル水素充電電池4本 専用ACアダプタ(オプション)
電池寿命	約500時間 ※常温、アルカリ電池使用、記録間隔1分、バックライトOFF、 測定値表示OFFのとき
材質	ABS
寸法	約(W) 158 × (H) 106 × (D) 40mm
質量	約420g(電池含む)
付属品	取扱説明書(仕様編、操作編) 各1部 単3形アルカリ電池 4本 SDカード 1枚 キャリングケース 1個


※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
 ※付属の電池はお試用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。

オプション

製品名	製品番号
SK-L400T用ACアダプタ	8191-90
屋外設置用防水ケース	8191-92
K熱電対用中継ケーブル	8250-40
ミニチュアコネクタ	8250-45
K熱電対センサ	弊社ホームページをご覧くださいか、お買い上げ店または弊社にご相談ください。

インターネットホームページ

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページをご覧ください。
<https://www.sksato.co.jp>

予約記録
<p>設定した日時に自動で記録を開始または停止する機能です。</p> <p>①記録間隔の設定</p> <p>P.5「記録間隔設定」を参照して設定してください。</p> <p>②予約スタート日時および予約ストップ日時の設定</p> <p>P.5「予約記録設定」を参照して設定してください。</p> <p>③予約スタート日時設定後、「ESC」キーを2秒以上押すと、RES キャラクタが点灯して予約記録待機状態になります。</p>


【予約待機中の操作】

- 予約待機中は測定値表示のON/OFFを切り替えることができます。表示のON/OFFは「MAX/MIN/▲」キーで切り替えます。
 - ※測定値を表示すると消費電力が大きくなり電池寿命が短くなります。必要のない場合は測定値表示をOFFにすることをお勧めします。
- MAX/MIN、HOLD、T1-T2、REL、メモ機能は使用できません。
- 「REC」キーを2秒以上押すと待機状態を解除して、記録を開始します。
 - 電源をOFFにすると待機状態は解除されます。
- ④設定した予約スタート日時になると自動で記録を開始します。
 - ※予約待機中にローバッテリーマークが点灯した場合でも記録を開始します。
- ⑤記録を停止するときは「REC」キーを2秒以上押してください。
 - REC** キャラクタが消灯して、測定状態に戻ります。予約ストップ日時を設定している場合は、ストップ日時になると自動で記録を停止します。

メモ機能																																													
<p>現在の測定値をメモする機能です。メモ機能には1データメモ、連続メモの2つの機能があります。</p> <p>【メモ動作】</p> <ul style="list-style-type: none">測定値はSDカードにテキスト形式で保存されます。初めてメモ機能を使用したときにファイル「SK001.TXT」が作成されます。以降、値をメモするごとに次の行にデータが記録されていきます。 <p>注意：メモ機能で保存したファイルは、市販の表計算ソフトなどで解析できます。「4ch温度ロガー for Windows」では解析できません。</p>																																													
<p>【データフォーマット】</p>																																													
<table> <tbody><tr> <th>記録方式</th> <th>年月日</th> <th>時分秒</th> <th>記録間隔</th> <th colspan="4">各チャンネルのデータ</th> <th>単位</th></tr> <tr> <td>MN/AT</td> <td>date</td> <td>time</td> <td>int</td> <td>1ch</td> <td>2ch</td> <td>3ch</td> <td>4ch</td> <td>unit</td></tr> <tr> <td>MN</td> <td>2011/1/2</td> <td>12:55:21</td> <td></td> <td>155.5</td> <td>300.5</td> <td>658.4</td> <td>1357</td> <td>C</td></tr> <tr> <td>MN</td> <td>2011/1/2</td> <td>13:55:54</td> <td></td> <td>155.1</td> <td>300.1</td> <td>653.2</td> <td>1341</td> <td>C</td></tr> <tr> <td>MN</td> <td>2011/1/4</td> <td>14:54:48</td> <td></td> <td>154.9</td> <td>299.5</td> <td>640.2</td> <td>1256</td> <td>C</td></tr> </tbody></table> <p>MN：メモ機能を意味します。記録間隔：空欄です。単位：C（℃）</p>	記録方式	年月日	時分秒	記録間隔	各チャンネルのデータ				単位	MN/AT	date	time	int	1ch	2ch	3ch	4ch	unit	MN	2011/1/2	12:55:21		155.5	300.5	658.4	1357	C	MN	2011/1/2	13:55:54		155.1	300.1	653.2	1341	C	MN	2011/1/4	14:54:48		154.9	299.5	640.2	1256	C
記録方式	年月日	時分秒	記録間隔	各チャンネルのデータ				単位																																					
MN/AT	date	time	int	1ch	2ch	3ch	4ch	unit																																					
MN	2011/1/2	12:55:21		155.5	300.5	658.4	1357	C																																					
MN	2011/1/2	13:55:54		155.1	300.1	653.2	1341	C																																					
MN	2011/1/4	14:54:48		154.9	299.5	640.2	1256	C																																					


<p>タイトル行</p> <p>測定データ</p>	<table> <tbody><tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody></table>																		

- SD** キャラクタが点灯していない場合や **FULL** キャラクタまたはローバッテリーマークが点灯している場合、メモ機能はご使用できません。
- MAX/MIN、HOLD、T1-T2、REL機能中に「MEMO」キーを押すと、各機能を解除して測定値を記録します。
 - ※オフセット値を設定している場合は、オフセット値を反映した値を記録します。

- 1データメモ**「MEMO」キーを押したときの測定値をSDカードに記録します。
 - 測定状態で「MEMO」キーを押してください。**MEMO** キャラクタが約5秒間点灯して、測定値を記録します。
 - 測定値の記録後、測定状態に戻ります。


- 連続メモ**「MEMO」キーを押している間、測定値を記録し続ける機能です。連続メモでは2秒間隔で測定値を記録します。
 - 測定状態で「MEMO」キーを押し続けてください。**MEMO** キャラクタが点灯して、測定値を記録し続けます。
 - 「MEMO」キーを離すと **MEMO** キャラクタが消灯して記録を停止し、測定状態に戻ります。

注意：連続メモ機能中もオートパワーオフ機能は有効です。20分以上連続メモ機能をご使用する場合、P.8「オートパワーオフ機能」を参照し、オートパワーオフ機能を解除してからご使用ください。

REL機能
<p>現在の測定値を基準（0.0℃に設定）にした相対値（測定値の変化）を見ることができます。</p> <p>●操作方法</p> <ol style="list-style-type: none">測定状態で「REL」キーを押してください。 <p>REL キャラクタが点灯して、各チャンネルの測定値が「0.0℃」になります。</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none">※センサ未接続のチャンネルはエラーを表示します。 ②解除する場合はもう一度「REL」キーを押してください。 <p>REL キャラクタが消灯し測定状態に戻ります。</p>


記録機能（ロガー機能）
<p>本器は設定した間隔で測定値をSDカードに記録します。記録方法には手動記録と予約記録があります。</p> <p>【記録動作】</p> <ul style="list-style-type: none">記録を開始するとSDカードにska形式ファイルを作成し、測定値を記録します。保存されたデータは、解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ作成や積算温度の演算、印刷をすることができます。 <ul style="list-style-type: none">※「4ch温度ロガー for Windows」ではska形式ファイルをcsv形式ファイルに変換することができます。市販の表計算ソフトを利用してデータ解析をおこないたい場合は、csv形式ファイルをご利用ください。 ファイル名は測定開始日時で作成されます。ファイル名の形式「AA BB CC DD.ska」 <p>月日時分</p> <p>例：4月11日10時15分の場合</p> <p>ファイル名「04111015.ska」</p> <p>・1ファイルのデータ数は最大で30,000データ（チャンネルごと）です。30,000データを超えると、新たにファイルを作成して記録を継続します。このときのファイル名は、新たにファイルを作成した日時で作成されます。 SD キャラクタが点灯していない場合や FULL キャラクタまたはローバッテリーマークが点灯している場合、記録の開始および予約記録設定をすることができません。</p> <p>注意：記録中にローバッテリーマークが点灯した場合、しばらくの間記録を継続しますが、電池が消耗すると記録を停止します。すぐに電池を交換してください。記録を継続したい場合はACアダプタからの給電に切り替えてください。</p>

- MAX/MIN、HOLD、T1-T2、REL機能中に記録を開始すると、各機能を解除して測定値を記録します。記録中はこれらの機能は無効となります。
 - ※オフセット値を設定している場合は、オフセット値を反映した値を記録します。
- 記録中は測定値表示のON/OFFを切り替えることができます。表示のON/OFFは「MAX/MIN/▲」キーで切り替えます。
 - ※測定値を表示すると消費電力が大きくなり電池寿命が短くなります。必要のない場合は測定値表示をOFFにすることをお勧めします。
- 記録中は電源をOFFにすることはできません。またオートパワーオフ機能は無効となります。電源をOFFにする場合は、記録を停止してからOFFにしてください。

手動記録
<p>キーを押したときから、設定した記録間隔で記録し続けます。</p> <ol style="list-style-type: none">記録間隔の設定 記録間隔設定」を参照して設定してください。 測定状態で「REC」キーを2秒以上押してください。測定値が消灯してREC キャラクタが点灯し、記録を開始します。


- 記録を停止するときは「REC」キーを2秒以上押してください。**REC** キャラクタが消灯して、測定状態に戻ります。

注意
<ul style="list-style-type: none">SDカードは、付属または動作確認済みのSDカードのご使用をお勧めします。その他のSDカードを使用すると正常に認識しない場合があります。 SDカードに貼られているラベルをはがさないでください。また新たにラベルやシールを貼らないでください。 SDカードの抜き差しは、必ず本器の電源をOFFにしてからおこなってください。電源がONの状態ではSDカードの抜き差しをすると、本器やSDカードが故障したり、データの消失・破損の原因となります。 SDカードに記録したデータはパソコンなどにバックアップをとることをお勧めします。SDカードのデータが消失・破損した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

センサの取り付け
<p>K熱電対センサ（オプション）を接続します。弊社オプションセンサ以外のセンサをご使用する場合、センサコネクタはK熱電対用のASTM（旧ANSI）ミニチュアコネクタをご使用ください。 注意：本器はK熱電対専用です。K熱電対以外のセンサやコネクタを使用した場合、正確な温度測定ができません。</p> <p>●センサの取り付け</p> <ol style="list-style-type: none">電源をOFFにしてください。 ご使用するチャンネルにK熱電対センサを接続します。プラグの極性に注意し、コネクタ部を持ってしっかり奥まで差し込んでください。


- センサの取り外し**
 - 電源をOFFにしてください。
 - コネクタ部を持って、まっすぐ引き抜いてください。

注意：断線するおそれがありますので、センサコードを持って引き抜かないでください。


測定
<ol style="list-style-type: none">「電源」キーを2秒以上押すと電源が入り、約2秒間全点灯して、測定状態になります。 <p>注意：センサが接続されていないチャンネルは「— — —」表示となります。SDカード内のデータ数が多い場合、または記録データ以外のファイルが保存されている場合、読み込みに時間が掛かり、測定状態になるまでの時間（全点灯時間）が長くなる場合があります。</p> 測定終了後は「電源」キーを2秒以上押して電源をOFFにしてください。

注意
<ul style="list-style-type: none">本器の周囲環境が急激に変化した場合、測定精度に影響するおそれがあります。周囲の環境に十分なじませた後に測定をおこなってください。
HOLD機能
<p>測定中に測定値の変化が大きいつきは、HOLD機能をご使用ください。</p> <p>●操作方法</p> <ol style="list-style-type: none">測定状態で「HOLD」キーを押してください。HOLD キャラクタが点灯して測定値を固定します。 解除する場合はもう一度「HOLD」キーを押してください。HOLD キャラクタが消灯し測定状態に戻ります。
MAX/MIN機能

本器は電源ONからの測定値を記憶し、最高値（MAX）および最低値（MIN）を表示することができます。

●**操作方法**

測定状態で「MAX/MIN」キーを押すごとに各チャンネルの最高値→最低値→測定値の順で表示します。表示部にはそれぞれ**MAX** または **MIN** キャラクタが点灯します。
注意：T1-T2機能またはREL機能を使用する場合は、それまでの最高値・最低値はリセットされ、それぞれの機能に切り替えたときからの最高値および最低値を表示します。また、電源をOFFにすると最高値・最低値はリセットされます。


T1-T2機能
<p>CH1の測定値からCH2の測定値を減じた値（温度差）を表示する機能です。</p> <p>●操作方法</p> <ol style="list-style-type: none">測定状態で「T1-T2」キーを2秒以上押してください。T1-T2キャラクタが点灯して、CH1の測定値からCH2の測定値を減じた値を表示します。 <ul style="list-style-type: none">※CH3およびCH4にセンサが接続されていても測定値は表示されません。 解除する場合はもう一度「T1-T2」キーを2秒以上押してください。T1-T2 キャラクタが消灯し測定状態に戻ります。


電池のセット
<ol style="list-style-type: none">電源をOFFにします。 電池フタをスライドして外します。 電池を交換するときは古い電池を外してください。電池の極性（＋）に注意し、電池をセットしてください。 電池フタを「カチッ」と音がするまでスライドして固定してください。 <p>注意：本器は、バックアップ機能により電池交換時でも約1分間は時計情報を保持しますが静電気や環境条件などによりリセットされる場合があります。電池交換後は、時計設定を確認してください。 ※記録間隔などほかの設定情報は、電池を抜いても保持されます。</p>

注意
<ul style="list-style-type: none">ローバッテリーマークが点灯したときは、速やかに新しい電池に交換してください。 電池はすべて新品で同じメーカー同じ種類の電池をご使用ください。種類が違ったり、古い電池と混ぜると破裂や液漏れのおそれがあります。 環境保全のため使用済みの電池はそれぞれの自治体の条例に基づいて処理するようお願いします。

ACアダプタの使用
<p>本器はACアダプタ（オプション）からの給電が可能です。ACアダプタ端子にACアダプタのプラグを差し込んでください。 ※本器は、ACアダプタと電池の両電源仕様です。ACアダプタ使用時でも、電池をセットしてお使いいただくことにより、停電時やACアダプタが外れた場合なども自動的に電池に切り替わり、継続動作が可能です。 ※ACアダプタと電池の併用時、ACアダプタからの給電が優先されます。 注意：電池はご使用環境や自然放電により徐々に消耗していきます。ACアダプタと電池を併用する場合、ローバッテリーマーク機能は動作しないため、定期的な電池残量の確認や交換をお勧めします。</p>

SDカードのセット
<p>本器は測定値をSDカードに記録します。記録されたデータはSDカードリーダーを利用してパソコンで読み込み、解析ソフトウェアでグラフ作成、印刷などができます。 ※SDカードリーダーは付属していません。市販のものを使用してください。</p> <p>●SDカードのセット</p> <ol style="list-style-type: none">電源をOFFにし、SDカードフタをスライドして外します。 SDカードをケースの刻印と同じ向きに挿入します。「カチッ」と音がするまで奥に挿入してください。 <p>注意：向きを間違えて挿入した場合、SDカードや本器の接続端子が破損するおそれがあります。</p> SDカードフタを「カチッ」と音がするまでスライドして固定してください。



- 電源を入れると、表示部に **SD** キャラクタが点灯します。
 - ※**SD** キャラクタが点灯しない場合、SDカードを認識できていません。電源をOFFにし、SDカードをセットし直してください。

注意：本器はSDカードが書き込み禁止（LOCK）に設定されている場合、SDカードを認識できません。書き込み禁止を解除してお使いください。
 - ※**SD** キャラクタが点滅している場合、SDカードの空き容量が少なくなっています。（SDカードの容量が約10MB以下のときに点滅します。）また、**FULL**キャラクタが点灯している場合、SDカードの空き容量がありません。SDカード容量を確保してから再度セットしてください。

- SDカードの取り外し**
 - 電源をOFFにしてください。
 - ケース裏面のSDカードフタをスライドして外します。
 - セットされているSDカードを「カチッ」と音がするまで奥に押し込むと、内部のバネでSDカードが押し出されます。
 - SDカードをまっすぐ引き抜いてください。
 - SDカードフタを「カチッ」と音がするまでスライドして固定してください。

- SDカードについて**

本器では付属のカードのほか、市販のSD/SDHCカードが使用可能です。市販のSDカードはフォーマット済みのものをお使いください。本器で対応しているフォーマット形式はFATまたはFAT32形式です。
※NTFS形式は本器では認識できません。
※弊社では下記のSDカードで動作を確認しています。

SanDisk社製	2GB「SDSDB-2048-J95B」
	4GB「SDSDB-4096-J95A」
	8GB「SDSDB-008G-J01」
	16GB「SDSDUNB-016G-GN3IN」
Panasonic社製	2GB「RP-SDL02GJ1K」
	8GB「RP-SDLC08G」
Transcend社製	2GB「TS2GSDC」

4ch温度ロガー SK-L400T

取扱説明書（操作編）

SK SATO

ご使用前に
<p>本書は4ch温度ロガー「SK-L400T」の操作説明です。◎ご使用前には必ず取扱説明書（本書）および別紙「取扱説明書（仕様編）」をお読みになり、大切に保管してください。解析ソフトウェアCD-ROMは付属していません。解析ソフトウェアは、弊社インターネットホームページからダウンロード（無償）いただけます。</p>
目次

各部の名称	頁
別紙（仕様編）	
電池のセット	1
ACアダプタの使用	1
SDカードのセット	1～2
センサの取り付け	2
測定	2～3
HOLD機能	2
MAX/MIN機能	2
T1-T2機能	2
REL機能	3
記録機能（ロガー機能）	3～4
手動記録	3
予約記録	4
メモ機能	4
各種設定	5～8
設定モードのフロー図	5
記録条件設定（P10）	5～6
警報設定（P20）	6～7
オフセット設定（P30）	7
時計設定（P40）	8
オートパワーオフ機能	8
バックライト機能	8
解析ソフトウェアの操作例	8
エラーメッセージ	9
トラブルシューティング	9

各種設定


設定モードでは以下の設定ができます。

No.	キャラクタ	内容
P10	r[]c	記録条件を設定します。
P20	AL	警報機能を設定します。
P30	oFSt	測定値のオフセットを設定します。
P40	oFt	時計を設定します。

●設定モードの操作

- 測定状態で「設定」キーを2秒以上押ししてください。温度表示部にP10キャラクタが点灯して、設定モードに切り替わります。
- 「▲」または「▼」キーを押して目的の設定項目を選択し、「ENTER」キーで確定します。
- 設定モードを終了したい場合は、「ESC」キーを2秒以上押しすと測定状態に戻ります。

●設定モードのフロー図

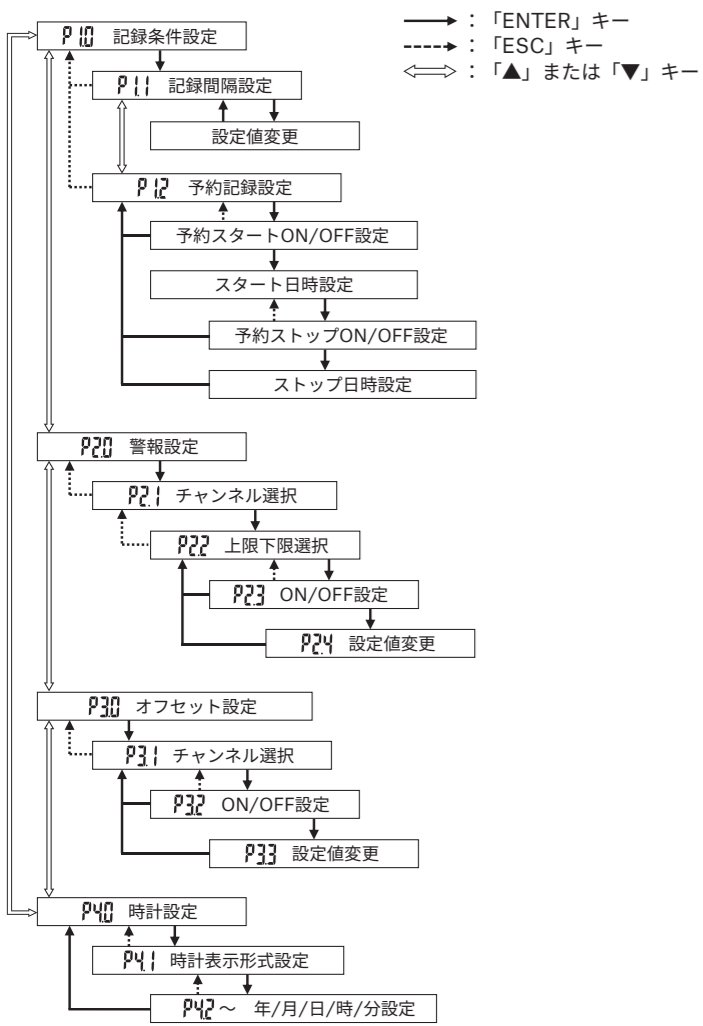


P10 記録条件設定

●記録間隔設定

測定値を記録する間隔を設定します。

- P10 記録条件設定を選択して「ENTER」キーを押してください。
- 「▲」または「▼」キーでP11記録間隔設定を選択し、「ENTER」キーを押してください。設定値変更画面になり、設定値が点滅表示します。



- 「▲」キーまたは「▼」キーで記録間隔を選択し、「ENTER」キーで決定します。5キャラクタは秒、nnキャラクタは分を表します。


●予約記録設定

予約記録とは、予め設定した時刻になったとき自動で記録をスタート/ストップする機能です。

- P10 記録条件設定を選択して「ENTER」キーを押してください。
- 「▲」または「▼」キーでP12予約記録設定を選択し、「ENTER」キーを押してください。予約スタート機能のON/OFF選択画面になります。




- 「▲」または「▼」キーでONを選択し、「ENTER」キーを押してください。スタート日時設定に移行します。
- スタート日時を年-月-日-時-分の順に設定します。「▲」または「▼」キーで値を選択し、「ENTER」キーで確定します。年の設定は、西暦の下二桁で設定してください。



注意：予約スタート日時を現在時刻より過去に設定した場合、エラーとなり、年の設定に戻ります。

- スタート日時を確定すると、予約ストップ機能のON/OFF選択画面になります。



- 「▲」または「▼」キーでONを選択し、「ENTER」キーを押してください。ストップ日時設定に移行します。予約ストップをおこなわないときは、OFFを選択してください。予約記録設定に戻ります。
- ストップ日時を年-月-日-時-分の順に設定します。「▲」または「▼」キーで値を選択し、「ENTER」キーで確定します。年の設定は、西暦の下二桁で設定してください。



注意：予約ストップ日時を予約スタート日時より過去に設定した場合、エラーとなり、年の設定に戻ります。

- 「ESC」キーを2秒以上押しして測定状態に戻ると、RESキャラクタが点灯し、予約記録の待機状態となります。

P20 警報設定

設定した警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。警報機能は、チャンネルごとに上限警報または下限警報を個別に設定することができます。

※警報機能を使用しない場合は、個々の設定をすべてOFFにしてください。出荷時はすべてOFFに設定されています。

●警報設定

- P20 警報設定を選択して「ENTER」キーを押してください。P21チャンネル選択に移行し、ALMキャラクタが点灯します。



- 「▲」または「▼」キーで警報を設定するチャンネルを選択し、「ENTER」キーを押してください。



- 「▲」または「▼」キーで上限警報 (Hi) もしくは下限警報 (Lo) を選択し、「ENTER」キーを押してください。警報のON/OFF設定に移行します。



- 「▲」または「▼」キーでONを選択し、「ENTER」キーを押すと警報値設定に移行します。



- 「▲」または「▼」キーで警報値を変更し、「ENTER」キーで確定します。※「▲」「▼」キーを長押しすることで値を早送りすることができます。警報初期値 Hi設定：100.0°C Lo設定：0.0°C

警報値を確定すると、上下限選択に戻ります。

続けて下限の警報値を設定したい場合は、③から同じ手順で設定してください。

ほかのチャンネルを設定する場合は、「ESC」キーを押してチャンネル設定に戻り、②から同じ手順で設定してください。

- 設定終了後、「ESC」キーを2秒以上押しして測定状態に戻ってください。警報が設定されている場合、表示部にALMキャラクタが点灯します。



●警報動作

測定値が警報設定値を超えると、約30秒間、超えたチャンネルのHiまたはLoキャラクタの点滅、ブザー音およびLEDランプの点滅でお知らせします。警報動作は約30秒後に自動的に停止します。途中で警報動作を止めたい場合は、何れかのキーを押してください。警報動作を停止したとき、HiまたはLoキャラクタは点灯に変わり、警報設定値を超えたこと示します。

HiまたはLoキャラクタをクリアするときは、「MAX/MIN」キーを2秒以上押ししてください。※HiまたはLoキャラクタは、設定モードへ移行したとき、また電源OFFでもクリアされます。

P30 オフセット設定

本器は測定値をシフト調整するオフセット値を設定することができます。オフセット値は、チャンネルごとに設定することができます。オフセット初期値：0.0°C オフセット設定範囲：±12.0°C オフセット設定は、測定値および記録データに反映されます。注意：オフセット設定は、既に記録済みのデータには反映しません。

●オフセット設定

- P30 オフセット設定を選択して「ENTER」キーを押してください。P31チャンネル選択に移行し、OFFSETキャラクタが点灯します。



- 「▲」または「▼」キーでオフセットを設定するチャンネルを選択し、「ENTER」キーを押してください。ON/OFF設定に移行します。



- 「▲」または「▼」キーでONを選択し、「ENTER」キーを押すとオフセット値設定に移行します。



- 「▲」または「▼」キーでオフセット値を変更し、「ENTER」キーで確定します。

オフセット値を確定すると、チャンネル選択に戻ります。続けてほかのチャンネルを設定する場合は、②から同じ手順で設定してください。

- 設定終了後、「ESC」キーを2秒以上押しして測定状態に戻ってください。オフセットが設定されている場合、表示部にOFFSETキャラクタが点灯します。



P40 時計設定

本器の時計設定をおこないます。

- P40 時計設定を選択して「ENTER」キーを押してください。P41時計表示形式設定に移行します。



- 「▲」または「▼」キーで時計表示形式を選択し、「ENTER」キーを押してください。

12H：12時間表示
24H：24時間表示

- 日時を年-月-日-時-分の順に設定します。

- 「▲」または「▼」キーで値を選択し、「ENTER」キーで確定します。年の設定は、西暦の下二桁で設定してください。



- 設定終了後、「ESC」キーを2秒以上押しして測定状態に戻ってください。

オートパワーオフ機能

本器は約20分間キー操作がない場合、オートパワーオフ機能が働き自動で電源がOFFになります。電源の切り忘れによる無駄な電力消費を防ぎます。連続測定をおこなう場合、オートパワーオフ機能を解除してください。※記録中はオートパワーオフ機能が無効となります。

●オートパワーオフの解除

電源OFF状態で「HOLD/T1-T2/▼」キーを押ししながら「電源」キーを2秒以上押しして電源を入れてください。表示部にHキャラクタが表示され、オートパワーオフ機能が解除されます。注意：電源を切るとオートパワーオフ解除設定は無効になります。オートパワーオフ機能の解除は電源を入れるたびに設定してください。


バックライト機能

本器はバックライトを点灯して暗い場所でも表示の確認ができます。電源ON状態で「バックライト」キーを押してください。バックライトが約10秒間点灯します。


解析ソフトウェアの操作例

解析ソフトウェアで記録データを開き、グラフ表示をおこないます。


- 解析ソフトウェアを起動します。
- 画面左上の「ファイル」から「開く」をクリックします。



- 解析するファイル (ska形式) を選択し「開く」をクリックしてください。

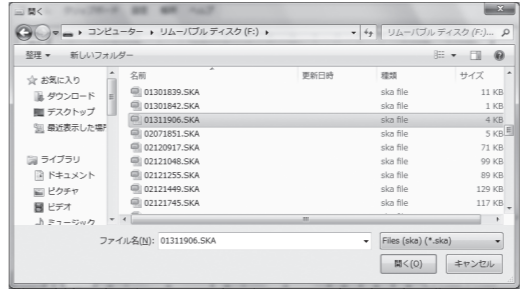

- ファイルを読み込み、自動でグラフを作成し表示します。

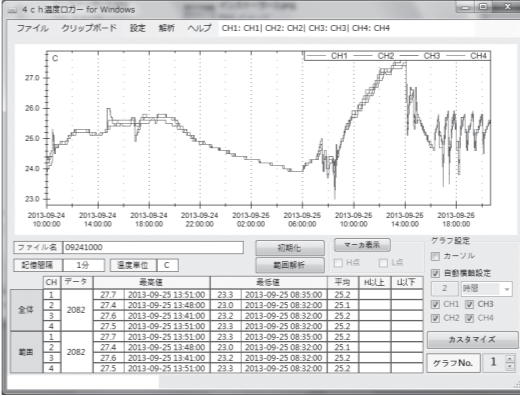

※詳しい機能や操作方法は解析ソフトウェアのヘルプをご参照ください。

エラーメッセージ

本器に異常が発生した場合、表示部にエラーコードを表示しお知らせします。

コード	内容	対策
E02	測定値が表示範囲の下限を超えています。	測定範囲内でご使用ください。
E03	測定値が表示範囲の上限を超えています。	
E04	演算エラーです。測定値がエラーの状態では演算機能を使用できません。	センサの接続状態を確認し、測定範囲内でご使用ください。
E07	測定環境が本体使用温度範囲の下限を超えています。	使用温度範囲内でご使用ください。
E08	測定環境が本体使用温度範囲の上限を超えています。	
E09	予約スタート/ストップ日時の設定が異常です。	予約スタート日時は現在日時よりも未来に設定してください。予約ストップ日時は予約スタート日時よりも未来に設定してください。
E10	SDカードの容量不足のため記録またはメモができません。	電源をOFFにし、SDカードの容量を確認、書き込み禁止 (Lock) の解除をおこなったうえで再度セットしてください。
E11	SDカードが認識できません。(予約待機中)	電源をOFFにし、再度SDカードをセットしてください。※予約記録をおこなう場合は、再度予約記録設定をおこなってください。
E12	SDカードが正常に読み込めません。	・SDカードが正しく接触していない可能性があります。 ・電源をOFFにし、SDカードの端子部にはこりやごみの付着がないこと、汚れていないことを確認し、再度セットしてください。 ・SDカードが本器に対応していない可能性があります。 P1「SDカードのセット」をご確認ください。
E13	電池残量不足のため記録またはメモができません。	新しい電池に交換してください。

トラブルシューティング

不具合症状	予想される原因	対策
電源が入らない	電池残量が不足している。 ACアダプタが外れている。	新しい電池に交換してください。 →P1「電池のセット」 ACアダプタを正しく接続してください。 →P1「ACアダプタの使用」
指示値が不安定	電氣的ノイズが発生する環境で使用している。 センサコネクタの接触不良。	本器およびセンサを電氣的ノイズが発生する機器から離してお使いください。 センサコネクタをしっかりと奥まで差し込んでください。 →P2「センサの取り付け」
指示値が異常	本器が周囲温度になじんでいない。 K熱電対以外のセンサを接続している。	本器を周囲温度になじませてから測定してください。 K熱電対センサを接続してください。
表示が異常	オフセット値が設定されている。 静電気等により誤動作している。	オフセット値の設定をご確認ください。 →P7「オフセット設定」 記録中の場合は記録を停止し、本体背面のリセットスイッチを細長い棒などで押しして本器を初期化してください。 ※時計設定は初期化されますので、リセット後は再度時計設定をおこなってください。記録間隔などほかの設定情報は保持されます。
	上記対策でも改善しない場合はお買い上げ店または弊社にご連絡ください。	