



ご使用前に付属品が不足していないか、本器が輸送中に破損していないかご確認ください。
万一付属品が不足していたり、本器や付属品が破損している場合は、お買い上げ店または弊社にご連絡ください。


- ①感温部
- ②握り手部（グリップ）
- ③コード
- ④センサコネクタ

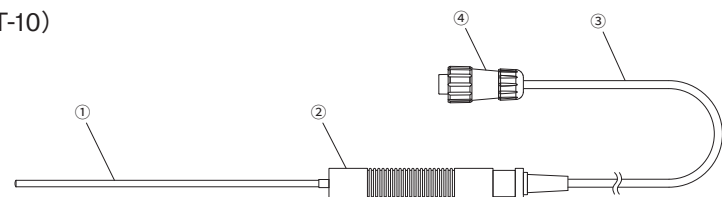


- ①感温部
- ②握り手部（グリップ）
- ③コード
- ④センサコネクタ

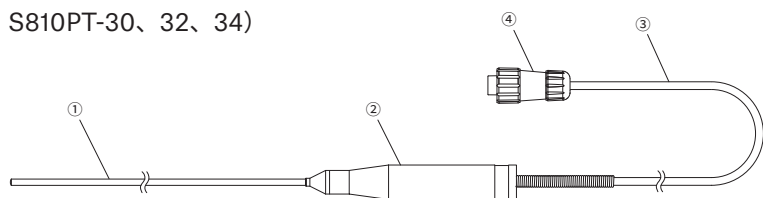

- ①感温部
- ②握り手部（スリーブ）
- ③コード
- ④センサコネクタ

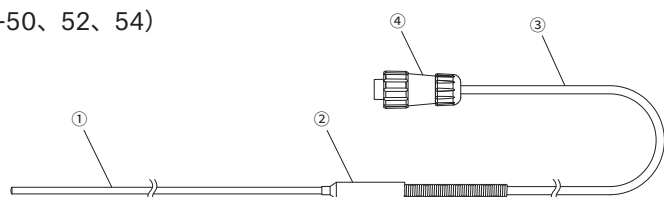

■設置用クリップの使用方法（設置用クリップはオプションです）
センサを設置用クリップに通してください。
鍋などの縁に設置用クリップをはさみ、固定してください。
※設置用クリップにセンサが固定されない場合、センサを通した
してください。
※センサが傾かないように、設置用クリップの支点が鍋などの縁

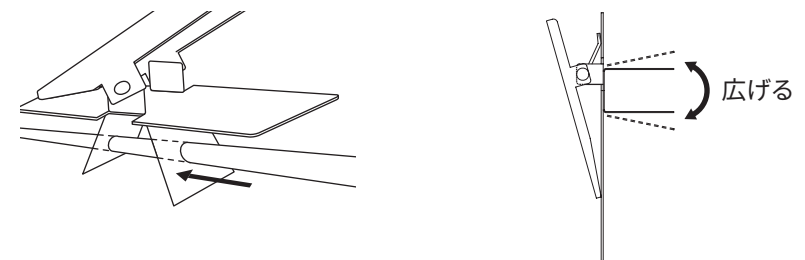

 注意

修理および校正はお買い上げ店または弊社へお申し付けください。

A diagram showing a power cord with a three-pronged plug being inserted into a device's power port. A large 'X' is drawn over the plug, indicating that this connection is incorrect.

■お手入れのしかた

- 810PT用汎用センサ/810PT用グリップセンサ
水道水による丸洗いができますが、洗浄の際は以下の点をお守りください。
 - ・水中に放置しないでください。
 - ・薬品および洗剤は使用しないでください。
 - ・洗浄後は乾いたウエスなどで水分をよく拭き取ってください。決して乾燥器などには入れないでください。
- 810PT用スリーブセンサ
水道水による丸洗いはできません。
汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませたタオルなどをよくしぼってから拭いてください。

仕様

製 品 名		810PT用汎用センサ
型 式		S810PT-10
製 品 番 号		8012-10
測 定 範 囲		－100～200℃
測 定 精 度		± (0.15℃+ 0.002 t) °C JIS C 1604 クラスA相当 ※ t は温度 (°C) の絶対値
セ ン サ		白金測温抵抗体 Pt100 4線式
防 水 性 能		JIS C 0920 IPX7準拠 ※指示計接続時
寸 法	感 温 部	約Φ3.2×150mm 先丸
	握り手部	約Φ15×100mm
	コ ー ド	約1.0m
材 質	感 温 部	SUS304
	握り手部	フェノール
	コ ー ド	フッ素
質 量		約80g
付 属 品		取扱説明書（本書） 1部

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※IPX7：常温の水中（水深1m）に30分間沈めても機器に有害な影響を生じる量の水の浸入がないこと。
ただし、水中でのご使用はできません。
※感温部の長さは、グリップの付け根までの寸法になります。

製 品 名		810PT用低温センサ (グリップ)	810PT用中温センサ (グリップ)	810PT用高温センサ (グリップ)
型 式		S810PT-30	S810PT-32	S810PT-34
製 品 番 号		8012-30	8012-32	8012-34
測 定 範 囲		－100～50℃	0～200℃	150～360℃
測 定 精 度		± 0.10℃		
セ ン サ		白金測温抵抗体 Pt100 4線式		
防 水 性 能		JIS C 0920 IPX7 準拠 ※指示計接続時		
寸 法	感 温 部	約Φ3.2×250mm 先丸		約Φ3.2×300mm 先丸
	握り手部	約Φ18×107mm		
	コ ー ド	約1.5m		
材 質	感 温 部	SUS316		
	握り手部	SUS304		
	コ ー ド	シリコン		
質 量		約208g		約210g
付 属 品		取扱説明書（本書） 1部		

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※IPX7：常温の水中（水深1m）に30分間沈めても機器に有害な影響を生じる量の水の浸入がないこと。
ただし、水中でのご使用はできません。

製 品 名		810PT用低温センサ (スリーブ)	810PT用中温センサ (スリーブ)	810PT用高温センサ (スリーブ)
型 式		S810PT-50	S810PT-52	S810PT-54
製 品 番 号		8012-50	8012-52	8012-54
測 定 範 囲		－100～50℃	0～200℃	150～360℃
測 定 精 度		± 0.10℃		
セ ン サ		白金測温抵抗体 Pt100 4線式		
寸 法	感 温 部	約Φ3.2×250mm 先丸		約Φ3.2×300mm 先丸
	握り手部	約Φ8×40mm		
	コ ー ド	約1.5m		
材 質	感 温 部	SUS316		
	握り手部	SUS304		
	コ ー ド	シリコン		
質 量		約65g		約67g
付 属 品		取扱説明書（本書） 1部		

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

オプション

製 品 名	製 品 番 号
SK-810PT用収納ケース（アルミケース）	8012-94
S810PT設置用クリップ	8012-92

インターネットホームページ

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。
<https://www.sksato.co.jp>

保証規定

- 1) 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ後1年間、無償で修理または交換させていただきます。
その他の責はご容赦願います。
- 2) 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買い上げ店または弊社にご持参またはご送付ください。
- 3) 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
イ．誤用・乱用および取扱不注意による故障
ロ．火災・地震・水害等の災害による故障
ハ．不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
ニ．使用中に生じた傷等の外観上の変化
ホ．消耗品および付属品の交換
ヘ．本証の提示がない場合および必要事項（お買い上げ日、販売店名等）の記入がない場合
- 4) 本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行いたしません。大切に保管してください。

品質保証書

お願い

本保証書はアフターサービスの際必要となります。
お手数でも※印箇所にご記入の上、本器の最終ご使用者
のお手元に保管してください。
※当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、製品の修理・
交換の製品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提
供することは一切ございません。

製品名

精密型デジタル温度計 SK-810PT 温度センサ

※お客様名

※ご住所

※TEL

●以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印をお願いいたします。

お買い上げ店名

ご住所

TEL

お買い上げ年月日

年

月

日

株式会社佐藤計量器製作所

101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-4

TEL 03-3254-8111 FAX 03-3254-8119

SK SATO

Y.02