


3・薬剤タンク

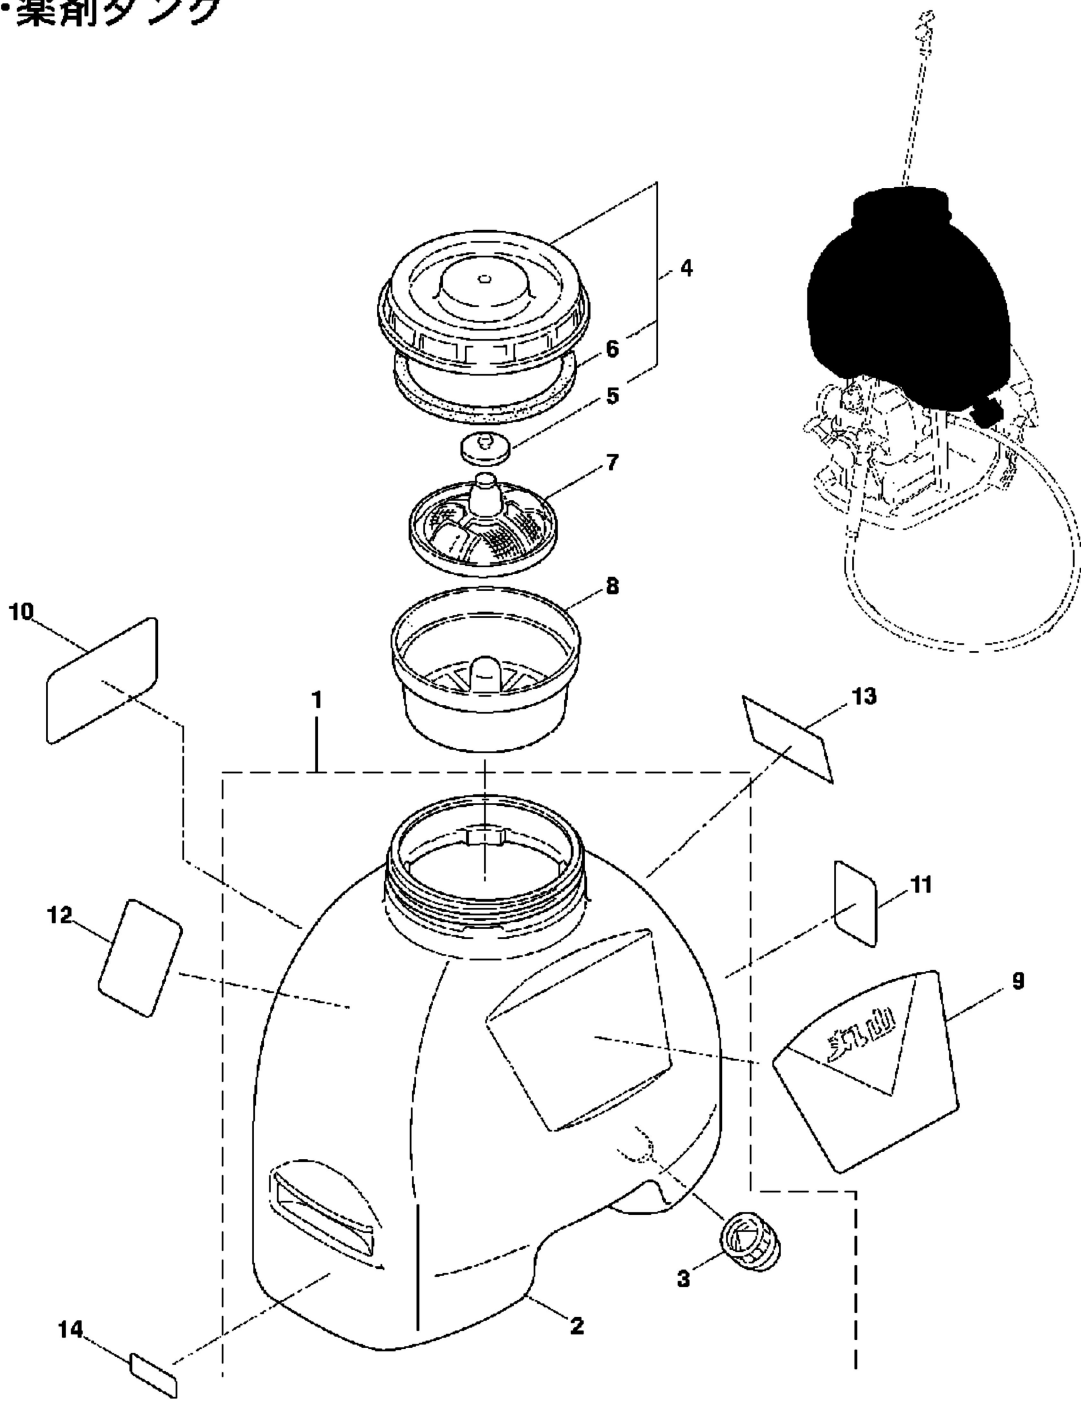

10

取替いの注意

ご取替の際、必ず以下の注意を必ず守ってください。

1. 必ず取替用の新品を必ず取り替えてください。
2. 新品を取り替える際は必ず、古い部品を完全に破棄してください。
3. 古い部品は、必ず破棄してください。必ず破棄してください。
4. 古い部品は、必ず破棄してください。必ず破棄してください。
5. 古い部品は、必ず破棄してください。必ず破棄してください。

— Dauphin —

1. These O-rings are a critical seal.
2. Do not reuse old O-rings. Always use a new one.
3. Do not use O-rings from other equipment.
4. Do not use O-rings from other equipment.
5. Do not use O-rings from other equipment.



12

危険

この製品は、高圧で噴射する薬剤を吐出する可能性があります。必ず安全に取扱いください。

注意

この製品は、高圧で噴射する薬剤を吐出する可能性があります。必ず安全に取扱いください。

注意

この製品は、高圧で噴射する薬剤を吐出する可能性があります。必ず安全に取扱いください。

MS058SP-20 / MS058SP-25

13

油防止

噴霧剤により噴射された薬剤が、油を除去する効果があります。必ず安全に取扱いください。

1. 噴霧剤の吐出を必ず確認してください。
2. 噴霧剤の吐出を必ず確認してください。
3. 噴霧剤の吐出を必ず確認してください。

14

運転注意

高速で運転しないでください。