

呼び寸法の区分	A級	B級	C級	特記な寸法公差
200F	± 0.05	± 0.1	± 0.3	は級とする
206 $\pm$ 500F	± 0.07	± 0.2	± 0.5	
506 $\pm$ 2500F	± 0.1	± 0.3	± 0.7	
2506 $\pm$ 10000F	± 0.2	± 0.5	± 1.2	
級	± 0.5	± 1.0	± 1.5	

オ-ダ-NO.

仕様 番

加工数

納	期
---	---

处	理
---	---

出	☒
---	---

確 認

△×				
△×				
△×				
△×				
△×				
△×	'18 06 19	新規作成。	原 田	大 森
REV	DATE	DESCRIPTION	REVISER	CHECK



仕 様

項目	作業	A作業	B作業	C作業
品 番		GF2-2503-RX-VPV	GF2-2506-RX-VPV	GF2-2510-RX-VPV
高圧側圧力計		25MPa計	25MPa計	25MPa計
低圧側圧力計		0.3MPa計	0.6MPa計	1MPa計
使用ガス		N ₂ , Ar, O ₂ , Air		
入口圧力		14.8MPa以下	14.8MPa以下	14.8MPa以下
中間セツト圧力		0.99MPa [P _i =8MPa時]	0.99MPa [P _i =8MPa時]	0.99MPa [P _i =8MPa時]
出口圧力		0～0.2MPa	0～0.4MPa	0～0.6MPa
安全弁作動	高圧側	1.5～2.5MPa	1.5～2.5MPa	1.5～2.5MPa
	低圧側	0.24～0.4MPa	0.5～0.9MPa	0.8～1.3MPa
入口継手		W22-14山 (右) 袋ナット		
出口継手		Rc1/4		
付属品		な し		
圧力調整ハンドル色		黒 色		
ダイヤフラム材質		NBR+テフロン保護板		
調整弁シート材質		ダイフロン・テフロン		
安全弁シート材質		バイトン		

△ 注 意

ガスボンベのバルブを急激に開放する事は危険です。発火事故につながる事がありますから、バルブはゆっくり開いて下さい。

P40885A (O₂の場合のみ貼付)

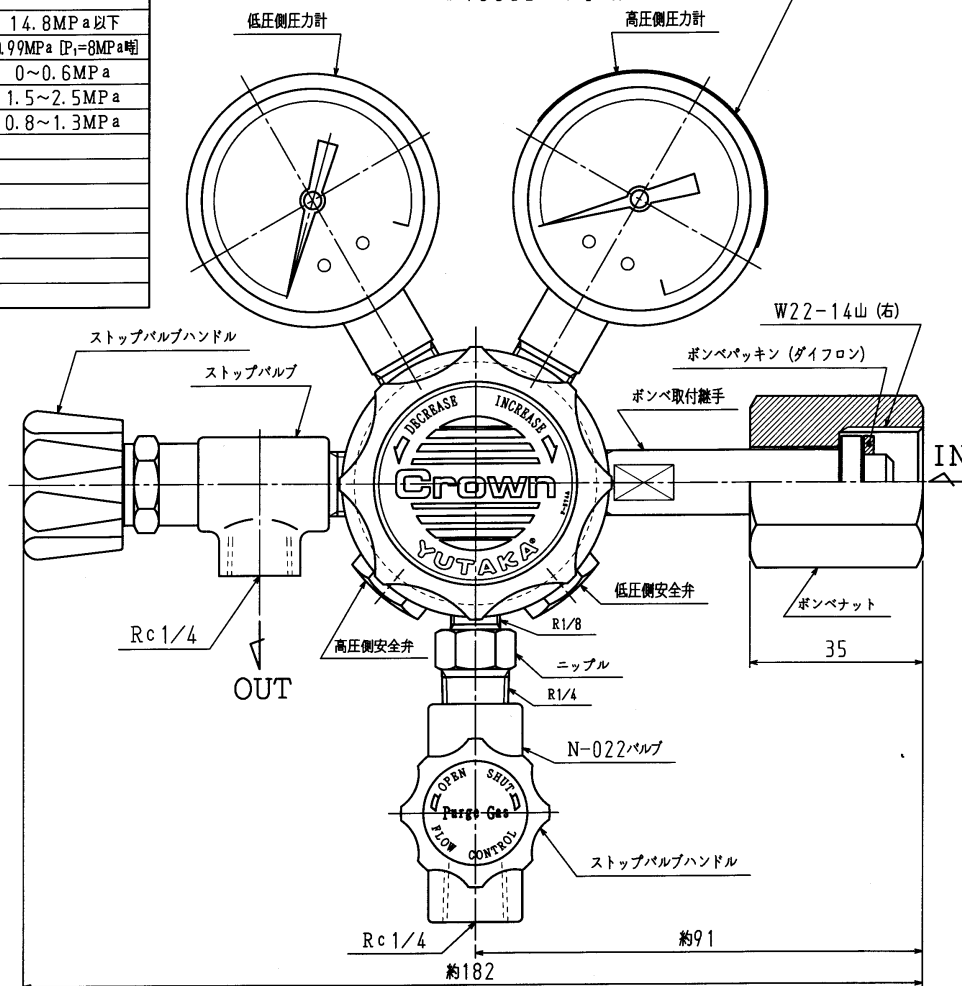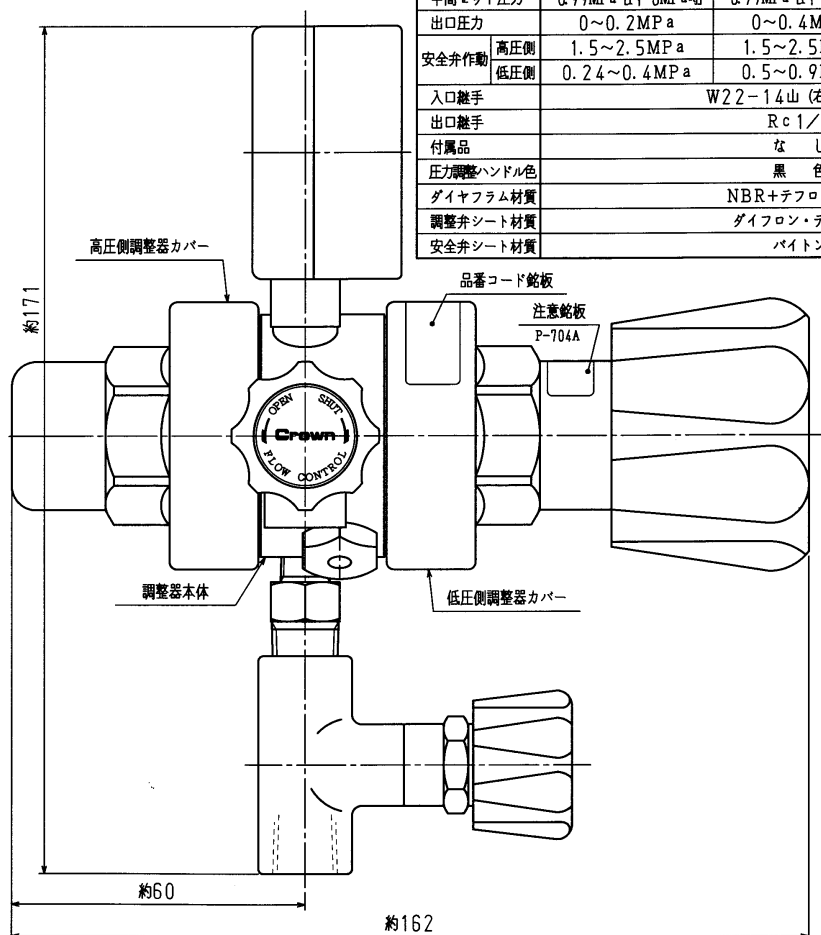

材 質	MATERIAL 接ガス部 C3604BD		処 理	TREATMENT Cr-3		特 殊 仕 樣 (G)	CUSTOM SPEC. (G)		品 番 形 式	PART NO. GF2-25□□-RX-VPV	
										MODEL GF2	
APP'D		CHECK	DESIGN	施 工 要 項	APPLICATION			名 称	TITLE		
原田 大森 18.6.19		大森 18.6.19	原田 18.06.19						ハイグレード仕様Brass製 二段式精密圧力調整器		
YUTAKA ENGINEERING CORPORATION								尺 寸	SCALE 1/1	図 番	DWG. NO. F37395