

## step 1 校正商品の決定

1. 商品名に【預かり再校正サービス】が付いている商品をお選びください。
2. 商品一覧より、必要な【品番】の商品を選び、【数量】をご記入ください。
3. 【バスケットに入れる】をクリック。

### 注意

- 製品品番がお客様がお使いのものと同じかご確認ください。



## step 2 ご注文

1. バスケット内に表示される【オプション設定】のボタンを押してください。
2. 注意事項を読んでいただき同意した上で 【宛名(会社名)】 【宛名(会社名ふりがな)】 【郵便番号】 【住所】 【電話番号(ハイフン不要)】 【FAX(ハイフン不要)】 【部署】 【担当者名】 【再校正希望品のシリアルNo】 【引取希望日】 【付属品】 を記入ください。
3. 【オプション設定する】のボタンを押してください。  
これでご注文が確定されます。




### step 3 商品引き渡し

校正が必要な本体は、[精密機器扱い]にてお客様で梱包など、引き渡しのご準備をお願いします。

当社手配の引取業者が商品集荷に伺います。

#### 注意

- 本体に著しい傷や破損がある場合や通常使用条件以外でのご使用による不具合発生等、またはご注文頂いた品番が異なる場合は、校正不可として着払いで返却させていただきます。
- 個別の見積もりに関しては一切受け付けておりません。
- 付属品は取り外してご発送ください。輸送中の付属品に生じうる汚損、破損、紛失等に関しては一切の責任を負いかねます。
- 個別の見積もりに関しては一切受け付けておりません。
- 電源が入らない、測定不可の状態等、校正が実施できない場合はキャンセルさせていただきます。

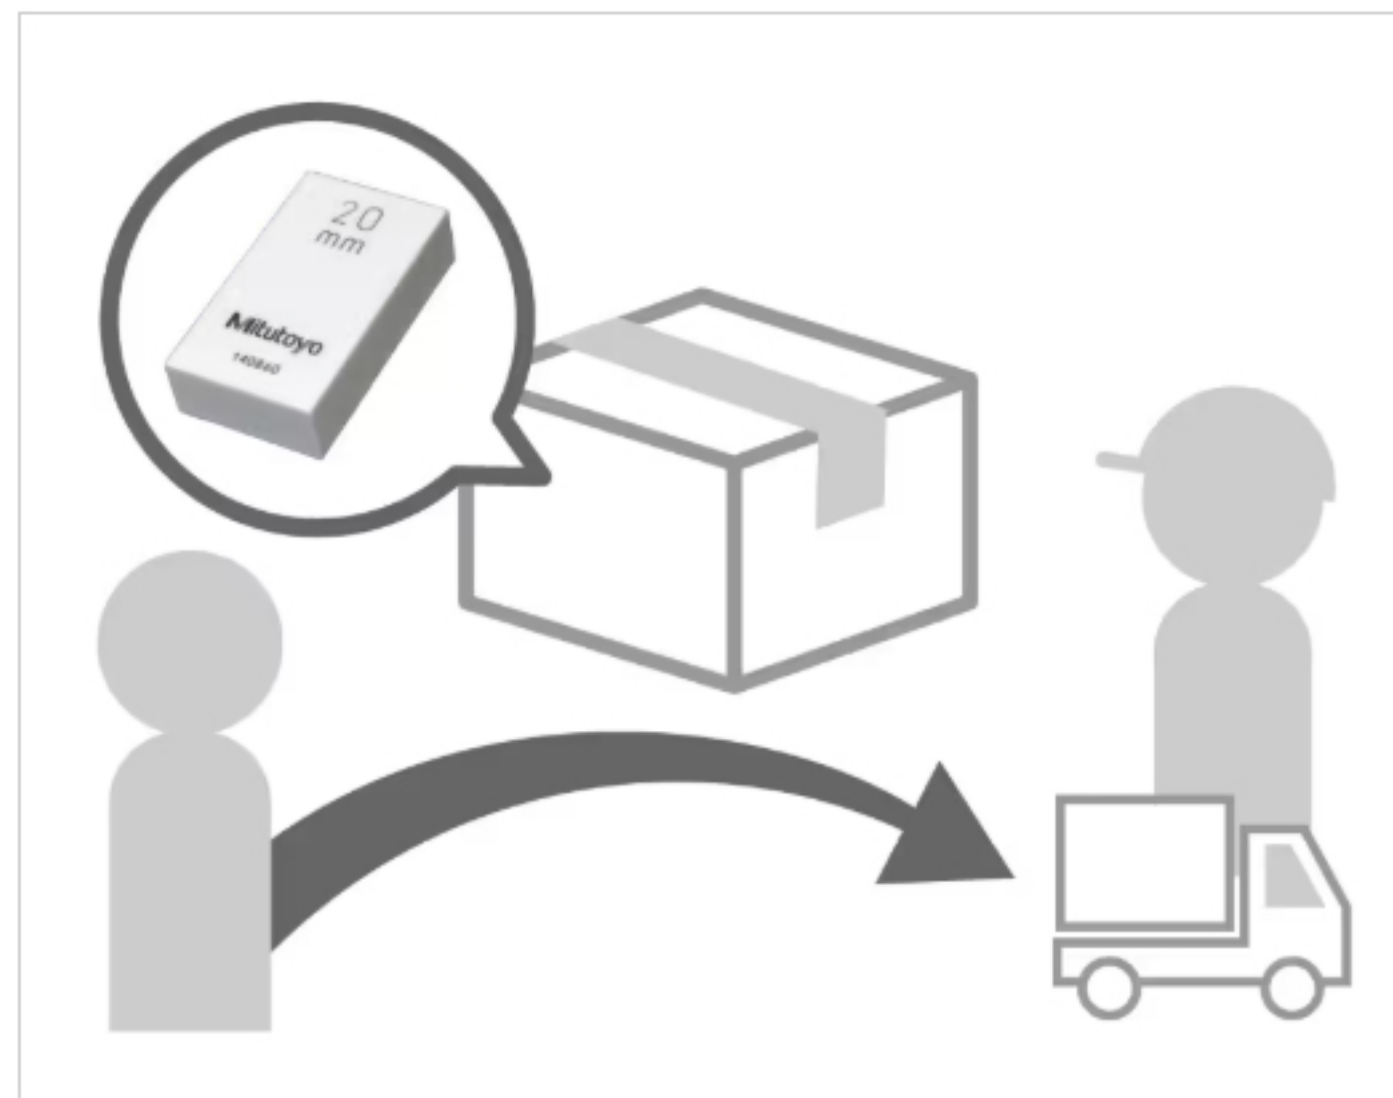

### step 4 校正後、返却送付

1. 商品を受領しましたら、校正実施へと進みます。
2. 校正作業が完了しましたら、速やかに返却いたします。
3. 製品到着後、動作の確認を実施してください。  
動作確認時における不具合の未改善、あるいは保証期間内に不具合再発の場合は速やかにご一報ください。弊社で責任を持って対応させていただきます。

#### 検査合格の場合

- 検査成績書(合否判定付)、校正証明書、トレサビリティ体系図 の3点セットを発行して返却いたします。

#### 検査不合格の場合

- 検査成績書のみ発行して返却いたします。  
校正証明書、トレサビリティ体系図は付属ございません。  
※不合格返却の場合でも返金はございません。

#### 外観検査落ちの場合

- 製品を預かった段階で破損していたり、精度から大きく外れている事が外観検査で判明した場合は詳細検査を行わず返却いたします。  
※外観検査落ちの場合は全額返金いたします。但し着払いにて返送とさせていただきます。

